

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie die Lieferrangfolge auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienststelle.

- Thermometer • Schutzhülle • Gebrauchsanweisung • 1 x 1,5V Batterie LR 41

ZECHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

! WARENUNG

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

! VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Gerät oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

INFORMATIONEN ZU DIESEM THERMOMETER**Temperaturmessung im After (rektal)**

Diese Messmethode ist am zuverlässigsten und am genauesten. Führen Sie hierzu die Thermometerspitze vorstülpig 2-3 cm in den After ein.

Temperaturmessung in der Mundhöhle (oral)

Führen Sie hierzu die Thermometerspitze in einer der beiden Wärmetaschen unter der Zunge oder neben der Zungenwurzel ein.

Temperaturmessung in der Achselhöhle (axillar)

Diese Messmethode ist relativ ungenau und kann deshalb aus medizinischer Sicht nicht empfohlen werden.

Messmethode	Empfohlene Messdauer	Mittlere Abweichung zur rektalen Methode
im After	bis zum Signalton	-
in der Mundhöhle	bis zum Signalton	-0,4 °C bis -1,5 °C (-0,7 °F bis -2,7 °F)
in der Achselhöhle	min. 5 Min.	-0,7 °C bis -2,0 °C (-1,26 °F bis -3,6 °F)

ANWENDUNG

Zum Einschalten drücken Sie kurz die EIN/AUS Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 Sek. einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar. Danach wird der letzte Messwert angezeigt. Danach erscheint das „Lo“ („Lo“) und „Hi“ („Hi“) angezeigt. Das Thermometer ist messbereit. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „C“ („F“)-Zeichen blinkt. Die Messung wird beendet, wenn eine Temperatursättigung erreicht ist. Ein akustisches Signal ertönt (10 lange Pieptöne), das „C“ („F“)-Zeichen blinkt nicht mehr und der gemessene Temperaturwert wird angezeigt. Solange die gesammelte Temperatur niedriger als 32 °C (98,6 °F) ist, blinks das Messsymbol „C“ („F“) und im Display „Lo“ („Lo“) angezeigt. Höhere Werte werden direkt angezeigt. Wenn die Temperatur über 37,8 °C (100 °F) oder höher genommen, erhält ein Fehlerindikator (30 kurze Pieptöne in 10 Sekunden). Werden Temperaturen über 42,9 °C (109,2 °F) gemessen, so erscheint das Symbol für „Hi“ C („Hi“). Die Messzeit ist verglichen mit herkömmlichen Thermometern stark verkürzt und beträgt bei der rektalen Messung nur ca. 10 Sekunden. Durch Verlängerung der Messdauer über den Signalton hinaus, werden genauere Messergebnisse erzielt. Bei Messungen in der Achselhöhle sollte die empfohlene Messdauer trotz Signalton eingehalten werden. Zur Verlängerung der Batterielebensdauer schalten Sie bitte nach der Messung das Thermometer durch kurzes Drücken der EIN/AUS-Taste aus. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten automatisch wieder mit automatisch durch den neuen Messwert ersetzt.

SPEICHER

Der letzter Messwert wird automatisch gespeichert. Um diesen Wert anzusehen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Zurück führt das Thermometer einen Selbsttest durch. Danach erscheint der zuletzt gespeicherte Messwert für ca. 2 Sek. Anschließend wird der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F) und „Lo“ im Display angezeigt. Das Thermometer ist messbereit und der alte gespeicherte Wert wird in der neuen Messanzeige angezeigt.

BATTERIEN**Batterien wechseln**

Das Fieberthermometer enthält eine Langzeit-Alkali-Mangan-Batterie (LR 41, 1,5 V) mit einer Batterielebensdauer von ca. 2000 Messungen. Die Batterie muss gewechselt werden, wenn das Batteriesymbol „Lo“ am rechten, untenen Rand zu blinken beginnt. Drücken Sie den Batteriefachdeckel am Ende des Gerätes mit den Fingern zusammen und ziehen Sie ihn kräftig nach unten weg. Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine Batterie gleicher Typs. Das „+“ Zeichen auf der Batterie muss nach oben zeigen. Stecken Sie anschließend den Batteriefachdeckel auf das Gehäuse auf.

REINIGUNG UND PFLEGE**Gerät reinigen**

Vor und nach jeder Benutzung muss das Gerät gereinigt und desinfiziert werden. Das Thermometer ist wasserfest und kann zur Reinigung bzw. Desinfektion in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie das Thermometer mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um Rückstände zu entfernen. Zur Desinfektion stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung. Tauchen Sie die Messspitze des Geräts für 10min in Isopropanol (70%) oder für 15 min in Heliopur® H plus N (Konzentration 1,5%). Spülen Sie die Messspitze des Thermometers mit Wasser nach der Desinfektion ab, um Rückstände des Desinfektionsmittels zu entfernen. Das Thermometer darf keinesfalls ausgesetzt werden! Anderer Desinfektionsmittel oder Methoden können Funktionsstörungen oder Beschädigungen verursachen.

Gerät lagern

Wenn Sie das Thermometer nicht benötigen, bewahren Sie es bitte in der originalen Schutzhülle auf. Das Gerät darf nicht bei hoher oder niedriger Temperatur oder Luftfeuchtigkeit („Technische Angaben“), im Sonnenlicht, in Verbindung mit elektrischem Strom oder an staubigen Orten gelagert oder benötigt werden. Es kann sonst zu Messgenauigkeitsverlusten kommen.

ZIELGRUPPE

Das Fieberthermometer ist zur medizinischen Versorgung in häuslicher Umgebung, nicht in professionellen Einrichtungen zur Gesundheitsfürsorge, vorgehalten. Der Nutzen des Fieberthermometers ist bei Neugeborenen ab 2,5 kg sowie für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder unter Aufsicht gegeben, während die Eigenanwendung für alle Personen ab 12 Jahren möglich ist.

KLINISCHE NUTZEN

Die aufgezeigten Messungen können bei der Diagnose und Therapie unterstützen. Eindeutige erhöhte Körpertemperatur vermutet. Der Anwender kann mit dem Thermometer erhöhte Körpertemperatur erkennen und einfache die menschliche Körpertemperatur im After, Mundhöhle oder der Achselhöhle messen und somit bestimmen, ob die betroffene Person Fieber hat.

Kontraindikation

• Die Anwendung des Thermometers an verschiedenen Personen kann bei bestimmten akuten, infektiösen Erkrankungen aufgrund einer möglichen Keimverschleppung, trotz der durchzuführenden Reinigung und Desinfektion, unzweckmäßig sein. Fragen Sie im Einzelfall Ihren behandelnden Arzt.

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten für eine ihrer Sicherheit zuständige Personen beaufsichtigt werden und von dieser Anweisungen darüber erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE**Allgemeine Hinweise****! WARNUNG**

• Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

• Halten Sie das Gerät von Kindern, Tieren und Ungeziefer fern.

• Die von Ihnen selbst ermittelten Messwerte können nur zu Ihrer Information dienen – sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung! Besprechen Sie Ihre gemessenen Werte mit dem Arzt und begründen Sie daher auf keinen Fall eigene medizinische Entscheidungen (z.B. hinsichtlich der Dosierung von Medikamenten).

• Bei auftretenden Temperaturergebnissen wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

! VORSICHT

• Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C gelagert wurde, lassen Sie es vor der Verwendung etwa 15 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C – 40 °C akklimatisieren.

• Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Kratzern, Schmutz, starken Temperaturschwankungen und direkter Sonneninstrahlung.

• Beleben Sie nicht auf das Thermometer (Messspitze). Dies kann zu Schäden und Verletzungen führen!

• Kontrollieren Sie das Thermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abrundung. Beschädigte oder abgerundete Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.

• Die Spitze darf nicht weiter als 90° abgebogen werden!

WARNHINWEIS

• Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C gelagert wurde, lassen Sie es vor der Verwendung etwa 15 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C – 40 °C akklimatisieren.

• Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten.

• Dieses Gerät ist mit einer flexiblen Messspitze ausgestattet und bringt dadurch mehr Komfort und Sicherheit bei der Messung, insbesondere bei Kleinkindern, Schläfern oder bewusstseinsgeschwächten Personen.

• Das Thermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.

Hinweise zum Umgang mit Batterien**! WARNUNG**

• Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C gelagert wurde, lassen Sie es vor der Verwendung etwa 15 Minuten bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C – 40 °C akklimatisieren.

• Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Kratzern, Schmutz, starken Temperaturschwankungen und direkter Sonneninstrahlung.

• Beleben Sie nicht auf das Thermometer (Messspitze). Dies kann zu Schäden und Verletzungen führen!

• Kontrollieren Sie das Thermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abrundung. Beschädigte oder abgerundete Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.

• Die Spitze darf nicht weiter als 90° abgebogen werden!

! VORSICHT

• Batterien in gut belüfteten, trockenen und kühlen Räumen in einem nicht leitenden Behältnis lagern, in dem die Batterien nicht gegenseitig oder durch andere Metalle gegenständen kurzgeschlossen werden können.

• Batterien sauber und trocken halten.

• Batterien von Wasser fernhalten.

• Bei längerer Nichtnutzung des Geräts, Batterien aus dem Batteriefach entnehmen.

HINWEIS

• keine wiederladbaren Batterien verwenden.

Hinweise zu elektromagnetischer Verträglichkeit

Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die die Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.

• Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infoledgesen können z.B. Fehlermeldungen oder ein Ausfall des Displays/ der Software auftreten.

• Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelte Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten diese Geräte in einem Abstand von 1 m voneinander positioniert werden, um sich überzuhören, die ein ordnungsgemäßes Gerät.

• Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenes, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störwellen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu einer Fehlerbehandlung des Gerätes führen.

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerät oder im Batteriefach.

Dieses Gerät entspricht den jeweiligen nationalen Bestimmungen und der europäischen Norm EN 60601-1-2 (Gruppe 1, Klasse B, Übereinstimmung mit CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-39) und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte dieses Gerät beeinflussen können.

Notes on electromagnetic compatibility

The device is intended for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.

The device may not be fully usable in the presence of electromagnetic interference. This could result in such errors as messages or the failure of the display/device.

Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner outlined above, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.

The use of accessories other than those specified or provided by the manufacturer of this device can lead to an increase in electromagnetic emissions or a decrease in the device's resistance to electromagnetic interference; this can result in faulty operation.

Failure to comply with the above could impair the performance of the device.

GARANTIE/SERVICE

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Hinweis zur Meldung von Fällen

Für Anwender / Patienten in der Europäischen Union und identischen Regelungssystemen gilt: Sollte sich während oder aufgrund der Anwendung des Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie den jeweiligen nationalen Behörden des Mitgliedstaates, in welchem sich der Anwender / Patient befindet.

Information about this thermometer

Temperature measurement in the anus (rectal)

This measurement method is the most reliable and accurate. Guide the tip of the thermometer carefully 2 to 3 cm into the anus.

Temperature measurement in the oral cavity (oral)

Insert the tip of the thermometer into one of the two heat pockets under the tongue or next to the root of the tongue.

Temperature measurement under the armpit (axillary)

This measurement method is relatively imprecise, therefore it cannot be recommended from a medical point of view.

Intervall und Änderungen vorbehalten

ENGLISH

ENGLISH

Read the instructions for use carefully and keep them for later use. Make them accessible to other users and note the information they contain.

INCLUDED IN DELIVERY


Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

Temperature measurement in the Achselhöhle (axillary)

This measurement method is relatively imprecise, therefore it cannot be recommended from a medical point of view.

MEASUREMENTS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

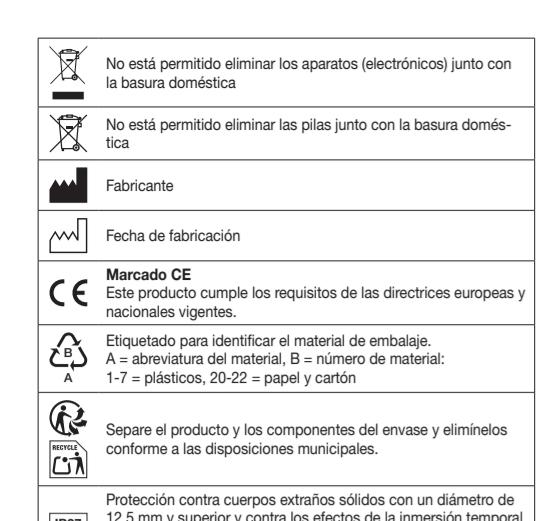

(10.2 °F), se muestra el símbolo de «Hi» («Hi» F). En comparación con los terómetros convencionales, el tiempo de medición necesario es muy reducido, siendo tan solo de unos 10 segundos por vía rectal. Si se alarga el tiempo de medición después de la señal acústica, se obtienen resultados más precisos. En el caso de la toma de la temperatura en la axila, es conveniente prolongar el tiempo para apreciar a pesar de la señal acústica. Para prolongar la vida útil de las pilas, apaguar el terómetro después de la medición pulsando brevemente la tecla ON/OFF. De lo contrario, el terómetro se desconecta automáticamente tras aprox. 10 minutos.

MEMORIA

El último valor medido se memoriza automáticamente. Para mostrar este valor pulsar el botón de encendido/apagado. El terómetro realiza en primera lugar una autocomprobación. A continuación se visualiza el último valor memorizado durante aprox. 2 s. Seguidamente se muestran en la pantalla el valor de referencia de 37 °C (98,6 °F) y la indicación «Lo». El terómetro está listo para la medición y el valor antiguo memorizado se reemplaza automáticamente por el nuevo valor.

MODIFICAR UNIDAD DE MEDICIÓN

Puede seleccionar que la temperatura se muestre en grados Celsius (°C) o en grados Fahrenheit (°F). Para realizar esta acción, mantener pulsado el botón de encendido y apagado más de 2 segundos al encender hasta que la unidad de medida cambie. El valor guardado se muestra en la nueva unidad de medida.

PILAS

El terómetro clínico contiene una pila alcálica de manganeso de larga duración (LR 41, 1,5 V) con una vida útil de aprox. 2000 mediciones. La pila deberá cambiarse cuando empieza a parpadear el símbolo de pila en la parte inferior derecha. Apriete con los dedos en la tapa de la pila que se encuentra en el extremo del terómetro y tire hacia fuera. Quite la pila antigua y sustitúela por una pila del mismo tipo. El símbolo + deberá quedar en la parte superior. Vuelva a colocar la tapa de la pila en su sitio.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpiar el aparato

El aparato debe limpíase y desinfectarse antes y después de usarlo. El terómetro es resistente al agua y puede sumergirse en agua o en una solución desinfectante para lavarlo o desinfectarlo. Limpie el terómetro antes de desinfectarlo. Para ello, limpie con un paño limpio y suave para eliminar los restos de desinfectante. No sumerja el terómetro en agua ni lo sumerja en agua de medición del aparato durante 10 min en alcohol isopropílico (al 70 %) o durante 15 min en Hélio® H plus N (al 1,5 %).

Después de la desinfección, enjuague la punta de medición del terómetro con agua para eliminar los restos de desinfectante. El terómetro no puede hervirse en ningún caso. Otros métodos o productos de desinfección pueden provocar daños en el aparato o alteraciones en su funcionamiento.

Almacenamiento del aparato

Si no se utiliza el terómetro, guárdelo en la tapa protectora original. El aparato no se debe usar ni guardar en un lugar expuesto a la luz solar con una temperatura demasiado alta o demasiado baja o con humedad ambiental («Datos técnicos»), en contacto con la corriente eléctrica o en lugares con exceso de polvo. De lo contrario, podría realizar mediciones imprecisas.

USO CORRECTO

Finalidad

El terómetro sirve únicamente para tomar la temperatura del cuerpo humano por vía oral, rectal o axilar. El terómetro está indicado únicamente para el uso privado en el hogar y no para el uso comercial.

Grupo objetivo

El terómetro clínico está previsto para los cuidados médicos en el entorno doméstico, no en instalaciones profesionales de asistencia sanitaria. El terómetro clínico apto para recibir nacidos a partir de 2,5 kg, así como para bebés, niños pequeños y niños bajo supervisión; mientras que el uso individual es posible para todas las personas a partir de 12 años.

Beneficios clínicos

Las mediciones registradas pueden ayudar en el diagnóstico y el tratamiento. **Indicaciones**

Se sospecha un aumento de la temperatura corporal. Con el terómetro, el usuario puede medir de forma rápida y sencilla la temperatura corporal humana en la cavidad bucal, el recto o la axila, y determinar así si la persona afectada tiene fiebre.

Contraindicaciones

• En el caso de determinadas enfermedades infecciosas agudas y para evitar el contagio de gérmenes, no se recomienda usar el terómetro en diferentes personas aun cuando sea limpido y desinfectado. Consulte cada caso individual con su médico.

• Las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas deben ser vigiladas por una persona responsable de su seguridad que les indicará como debe utilizar el aparato.

INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y DE SEGURIDAD

Avisos generales

ADVERTENCIA

• Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Evite peligro de aplastamiento.

• Mantenga el aparato fuera del alcance de niños, animales y parásitos.

• Los valores obtenidos solo tienen carácter informativo, en ningún caso pueden sustituir a un examen médico. Comente con su médico los valores que obtenga. [Ba] ningún concepto debe tomarse usted mismo decisiones médicas (p. ej., en relación con la dosis de medicamentos!]

• En caso de obtener un valor significativo, acuda sin demora a su médico de cabecera.

ATENCIÓN

• Si el aparato se ha almacenado a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 40 °C, deje que se aclimate durante unos 15 minutos a una temperatura entre de 5 °C y 40 °C antes de utilizarlo.

• Proteja el aparato de impactos, humedad, suciedad, grandes oscilaciones térmicas y la exposición directa a la luz solar.

• No muera el terómetro (punta de medición). Hacerlo puede provocar daños y heridas graves.

• Antes de cada utilización del terómetro, compruebe que no esté dañado o desgastado. Los terómetros dañados o desgastados no deben seguir usándose.

• Una punta no debe doblarse más de 90°.

• El terómetro debe utilizarse exclusivamente para medir la temperatura corporal en personas.

• El terómetro solo está previsto para su uso en los puntos de medición del cuerpo humano indicados en las instrucciones de uso.

• La medición de la temperatura debe durar siempre, y como mínimo, hasta la señal acústica.

• Este terómetro dispone de una punta flexible que permite una medición más cómoda y segura, especialmente en niños pequeños, personas dormidas o con pérdida parcial de la conciencia.

• Al encenderse, el terómetro realiza una autocomprobación. No es necesario controlar la exactitud de la medición.

Indicaciones para la manipulación de pilas

ADVERTENCIA

• ¡Peligro de explosión! ¡Peligro de incendio! El incumplimiento de las siguientes indicaciones podría ocasionar lesiones personales, daños en la pila, sobrecalentamiento, fugas, escapes, roturas, explosión e incendio.

• Este aparato contiene pilas no recargables que no deben recargarse.

• No arroje las pilas al fuego.

• No cargue, descargue, caliente, desmonte, abra, trite, deformé, encapule ni modifique nunca las pilas.

• No cortocircuite nunca las pilas ni los contactos del compartimento de las pilas.

• Proporcione las pilas de la fuente directa, la lluvia, el calor y el agua.

• La exposición de las pilas a temperaturas elevadas o a presión atmosférica extremadamente baja puede provocar explosiones o fugas de líquidos y gases inflamables.

• Elimine las pilas defectuosas y descargadas de inmediato y de forma adecuada (véase el capítulo Eliminación).

• No utilice pilas modificadas o dañadas.

• Seleccione siempre el tipo de pila correcto.

• Coloque las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+/-).

• Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y límpie el compartimento de las pilas con un trapito.

• En caso de que la pila se atasque en el aparato, quite la pila y los objetos extraños de inmediato con las herramientas médicas.

• Peligro de sofocación Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, lesiones internas graves y la muerte.

• No permita nunca que los niños cambien las pilas sin la supervisión de un adulto.

ATENCIÓN

• Guarde las pilas en un lugar bien ventilado, seco y fresco, en un recipiente no conductor donde las pilas no puedan cortocircuitarse entre sí ni con otros objetos metálicos.

• Mantenga las pilas limpias y secas.

• Mantenga las pilas alejadas del agua.

• Si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas de su compartimento.

AVISO

• No utilice pilas recargables.

Avisos relativos a la compatibilidad electromagnética

• El aparato se ha diseñado para usarse en todos los entornos que se especifican en estas instrucciones de uso, incluido el ámbito doméstico.

• En presencia de interferencias electromagnéticas, la utilización del aparato puede verse limitada en determinados casos. Como consecuencia, podrían mostrarse mensajes de error o podría apagarse la pantalla o el aparato.

• Se debe evitar el uso de este aparato junto a otros aparatos o apilado con ellos ya que esto podría provocar un funcionamiento incorrecto. Pero si resulta inevitable, se deben separar los aparatos y los demás aparatos para asegurarse de que no interfieran.

• El uso de accesorios distintos de los indicados o facilitados por el fabricante de este aparato puede tener como consecuencia mayores interferencias electromagnéticas o una menor resistencia contra interferencias electromagnéticas del aparato y provocar un funcionamiento incorrecto.

• Si no se tienen en cuenta estas indicaciones, podrían verse afectadas las características de funcionamiento del aparato.

INFORMACIÓN SOBRE ESTE TERMÓMETRO

Medición de la temperatura en el *anterior* (vía rectal)

Este método es el más fiable y preciso. Introduzca con cuidado la punta del terómetro en el anus unos 2-3 cm.

Medición de la temperatura en la boca (vía oral)

Introduzca la punta del terómetro debajo de la lengua (en el espacio sublingual), a la izquierda o a la derecha) o cerca de la raíz de la misma.

Medición de la temperatura en la axila (vía axilar)

Este método de medición es relativamente impreciso y por tanto no se puede recomendar desde un punto de vista médico.

Método de medición	Duración recomendada de la medición	Desviación media con respecto al método rectal
en el ano	hasta la señal acústica	-
en la boca	hasta la señal acústica	-0,4 °C a -1,5 °C (-0,7 °F a -2,7 °F)
en la axila	min. 5 min	-0,7 °C a -2,0 °C (-1,2 °F a -3,6 °F)

APLICACIÓN

Para encender, pulse brevemente la tecla ON/OFF. Una

breve señal acústica indicará que se ha encendido. En primer

lugar, el terómetro realiza un test de 2 s para comprobar su

buen funcionamiento. Durante este tiempo se visualizan todos los segmentos de la pantalla. A continuación se visualizará el valor medido. Luego aparecerá la señal acústica de «Lo» («Lo» F).

Algunas veces, el terómetro tarda más de 10 segundos en

aparecer la señal acústica. A continuación se visualizará el símbolo de medición «Lo» («Lo» F).

El terómetro está listo para realizar la medición. Durante la

medición, la temperatura actual se cambia manteniendo el signo «+» («+» F) para

indicar la medición rectal. La señal acústica (10 pitidos largos), «+» («+» F) dejará de aparecer. El terómetro procede inmediatamente

a la medición. A continuación se visualizará el valor medido. Luego aparecerá la señal acústica de «Lo» («Lo» F).

Algunas veces, el terómetro tarda más de 10 segundos en

aparecer la señal acústica. A continuación se visualizará el símbolo de medición «Lo» («Lo» F).

El terómetro está listo para realizar la medición. Durante la

medición, la temperatura actual se cambia manteniendo el signo «+» («+» F) para

indicar la medición rectal. La señal acústica (10 pitidos largos), «+» («+» F) dejará de aparecer. El terómetro procede inmediatamente

a la medición. A continuación se visualizará el valor medido. Luego aparecerá la señal acústica de «Lo» («Lo» F).

Algunas veces, el terómetro tarda más de 10 segundos en

aparecer la señal acústica. A continuación se visualizará el símbolo de medición «Lo» («Lo» F).

El terómetro está listo para realizar la medición. Durante la

medición, la temperatura actual se cambia manteniendo el signo «+» («+» F) para

indicar la medición rectal. La señal acústica (10 pitidos largos), «+» («+» F) dejará de aparecer. El terómetro procede inmediatamente

a la medición. A continuación se visualizará el valor medido. Luego aparecerá la señal acústica de «Lo» («Lo» F).

Algunas veces, el terómetro tarda más de 10 segundos en

aparecer la señal acústica. A continuación se visualizará el símbolo de medición «Lo» («Lo» F).

El terómetro está listo para realizar la medición. Durante la

medición, la temperatura actual se cambia manteniendo el signo «+» («+» F) para

indicar la medición rectal. La señal acústica (10 pitidos largos), «+» («+» F) dejará de aparecer. El terómetro procede inmediatamente

a la medición. A continuación se visualizará el valor medido. Luego aparecerá la señal acústica de «Lo» («Lo» F).

Algunas veces, el terómetro tarda más de 10 segundos en

aparecer la señal acústica. A continuación se visualizará el símbolo de medición «Lo» («Lo» F).

El terómetro